



Igarapé-Miri, 10 de Novembro de 2021.

Memorando nº 112/2021/SEMSA
DA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
PARA: GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAL



Assunto: Solicitação de autorização para realização e abertura de processo licitatório.

Considerando que o **Foco cirúrgico** é um dispositivo médico destinado a auxiliar a equipe médica durante um procedimento **cirúrgico**, iluminando uma área local ou cavidade do paciente.

Considerando que o **Foco Cirúrgico** é o equipamento usado para iluminar o campo de atuação nas cirurgias. Foi projetado de tal forma a manter a funcionalidade e praticidade através de rodízios o que facilitam sua locomoção de um local para o outro, braço articulado que propicia o direcionamento do **foco** de luz fria.

Senhor (a),

A Gerência de Planejamento - SEMSA, em resposta a solicitação do ofício nº280/2021-HMS, tendo em vista à necessidade premente de Administração Pública Municipal as atividades administrativas desta secretaria venho através deste, solicitar de vossa excelência a autorização para realização e abertura de processo licitatório, para aquisição de 01(um) equipamento de **FOCO CIRURGICO**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Igarapé-Miri.

Certos de contarmos com sua costumeira atenção, solicito autorização para que na forma da lei, encaminhe a referido termo o mais breve possível para o setor competente realizar pesquisa de preço e futuras providências administrativas.

Atenciosamente,

Mauro Benedito P. Pantoja
Gerente Técnico em Saúde
Port.: 323/2021 GAB/PMI


MAURO BENEDITO PANTOJA
GERENTE TÉCNICO EM PLANEJAMENTO
Portaria 323/2021/GAB/PMI

Mauro Benedito P. Pantoja
Gerente Técnico em Saúde
Port.: 323/2021 GAB/PMI



Estado do Pará Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
Secretaria Municipal de Saúde



Ofício nº 280/2021



Igarapé-Miri/PA, 09 de novembro de 2021

Para: Secretaria Municipal de Saúde
Igarapé-Miri/PA

Assunto: QUEIMA DE APARELHO – FOCO CIRURGICO

Senhora;

Tendo em vista a extrema necessidade do aparelho acima citado, solicitamos providencias a serem tomadas, uma vez que o aparelho hoje usado no Hospital, encontra-se inutilizável devido o mesmo conforme mostra imagens abaixo está quebrado. A falta do aparelho ocasiona diariamente transtornos aos munícipes, sendo de que solicitamos urgente providências para a normalização dos atendimentos.

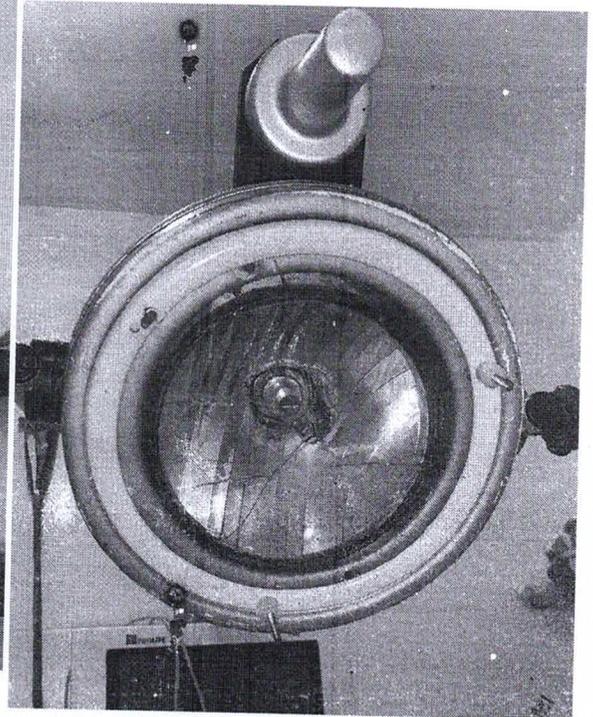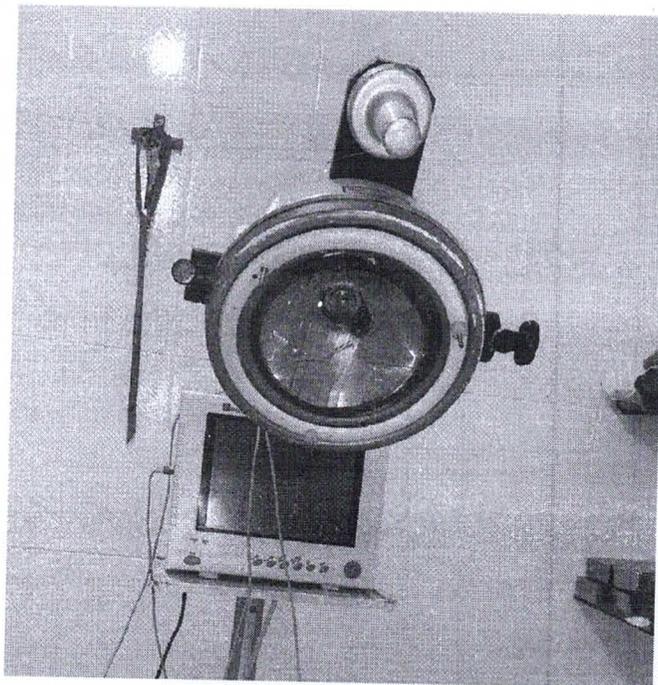

Constância Almeida Trindade
Dir. Administrativa H.M.S
RG 2880092
Responsável

Encaminho ao setor de compras para providencia do aparelho.