

Comprador - Prefeitura Municipal de Xinguara

Cotação - aparelho de ultrassonografia ecográfico eletrônico de alta resolução sistema windows

Pesquisado em 05/04/2022 16:28

Termos Pesquisados

1) APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS	532021	19/10/2021	2	152.000,0000
ComprasNet	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6042021	08/11/2021	1	168.000,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 160.000,0000		R\$ 168.000,0000	R\$ 152.000,0000	R\$ 168.000,0000	

Detalhamento de Preços

Item 1: APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS	532021	ComprasNet	19/10/2021

Produto Licitado

Aparelho ultrassonografia --- Aparelho ultrassonografia, material gabinete: unidade c, rodízio, aplicação: uso intraoperatório, características adicionais: tela 15" sensível ao toque, impressora, componentes: disquete, cd-rom, altofalante, outros componentes: software armazena dados, relatório personalizado, uso: fluxo sanguíneo, débito cardíaco, doppler pulsado

Lote/Item

0 / 8

Vencedor

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Preço Homologado 152.000,0000
Quantidade 2,00 Unidade

Marca/Fabricante

/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6042021	ComprasNet	08/11/2021

Produto Licitado

Aparelho ultrassonografia --- Aparelho ultrassonografia, material gabinete: led lcd, sensível toque, mínimo 20", aplicação: diagnóstico, características adicionais: doppler colorido, cego, pulsado, bidirecional, b,m, componentes: linear, convexo, setorial, elastografia, outros componentes: transesofágico, endocavitário, intra operatório, componentes adicionais: software 3d a mão livre e automático

Lote/Item

0 / 1

Vencedor

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Preço Homologado 168.000,0000
Quantidade 1,00 Unidade

Marca/Fabricante

/





PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

CNPJ: 04.144.150/0001-20

Responsável: ROBERTO DA SILVA ALVES

Matrícula: 026/2021

Telefone: (94) 99123-0835

Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



Relatório de Cotação: ultrassom 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis

Pesquisa realizada entre 03/08/2022 08:14:24 e 03/08/2022 08:14:34

Relatório gerado no dia 03/08/2022 08:18:40 (IP: 45.7.27.214)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.



Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica: imagem em modo 2d	2	1 Unidade	R\$ 137.024,38 (un)	-	R\$ 137.024,38	R\$ 137.024,38

Valor Global: R\$ 137.024,38

Valor do item em relação ao total

● 1) ultrassom ...

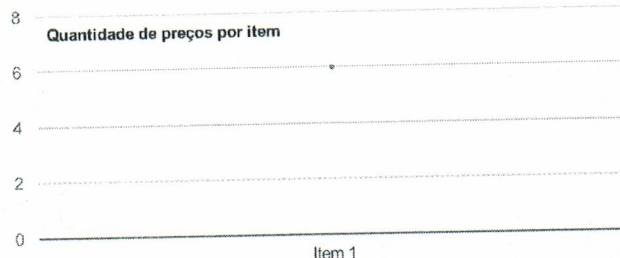

Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 03/08/2022 08:18:40 (IP: 45.7.27.214)

Código Validação: EQzeJ%2fIo8XRm%2fBD3O0eDghVambNKgmuyYqqA3eLPjSK2pjulx2OPxD6py2N9Dud8acPSbG%2brg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=EQzeJ%252fIo8XRm%252fBD3O0eDghVambNKgmuyYqqA3eLPjSK2pjulx2OPxD6py2N9Dud8acPSbG%252brg%253d)

token=EQzeJ%252fIo8XRm%252fBD3O0eDghVambNKgmuyYqqA3eLPjSK2pjulx2OPxD6py2N9Dud8acPSbG%252brg%253d

Item 1: ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica: imagem em modo 2d

Preço Estimado: R\$ 137.024,38 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 137.024,38 Média dos Preços Obtidos: R\$ 137.024,38

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica: imagem em modo 2d, modo m, modo m anatômico. modo power doppler, modo color doppler, modo doppler espectral e doppler contínuo. modo 2d. console ergonômico com teclas programáveis. tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom read/write. imagem trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. imagem harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. imagem harmônica de pulso invertido. modo m, modo power doppler, modo color doppler. modo dual live: divisão de imagem em tela dupla de modo b + modo color, ambos em tempo real. power doppler direcional. modo doppler espectral. modo doppler contínuo. tissue doppler imaging (tdi) colorido e espectral. modo triplex. pacote de cálculos específicos. pacote de cálculos simplificados. tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em modo b e modo doppler. divisão de tela em no mínimo 1,2e 4 imagens para visualização e análise de imagens em modo b, modo m, modo power, modo color, modo espectral, dual - modo de divisão dupla de tela com combinações de modos. software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. software de análise automática em tempo real da curva doppler. permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. possibilitar armazenar as imagens em movimento. cine loop e cine loop save. pós-processamento de medidas. pós-processamento de imagens. banco de palavras em português. monitor lcd ou led com no mínimo 17 polegadas. deve permitir arquivar/revisar imagens. frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. hd ou ssd interno de no mínimo 500 gb. 04 portas usb no mínimo. mínimo de 03 portas ativas para transdutores. conectividade de rede dicom. dicom 3.0 (media storage, verification, print, storage, storage/commitment, workflow, query-retrieve, mpps (modality performance procedure step), structured reporting). drive (gravador) de dvd-r para armazenamento de imagens e/ou clipes em cd ou dvd regravável, no formato: ou jpeg / avi ou mpeg (padrão windows) ou dicom com visualizador dicom de leitura automática. gravação de imagens em pen drive. impressão direta. pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: transdutor convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 mhz; transdutor endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 mhz; transdutor linear que atenda as frequências de 2.0 a 11 mhz; transdutor setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 mhz. acessórios: impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. tensão de acordo com a entidade solicitante.	a descrição complementar estará no edital.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 129.916,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material permanente – Equipamentos odontológicos e médicos hospitalares, que serão custeados através de recursos federais, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança

Data: 14/06/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 43467

Lote/Item: 7/7

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA



Descrição: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSEOFÁGICA: imagem em Modo 2D - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSEOFÁGICA: imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query -Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 98.750,00
Marca: MINDRAY Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSEOFÁGICA - imagem em Modo 2D. Modo M, modo M Anatômico. Mo		
10.493.078/0001-49	IBI LIFE MEDICAL EIRELI	R\$ 145.000,00
Marca: VINNO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: E 10		
17.737.428/0001-14	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 146.000,00
VENCEDOR Marca: VINNO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: X1		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 144.132,10

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO/RJ

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE

Data: 08/06/2022 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 03/08/2022 08:18:40 (IP: 45.7.27.214)
 Código Validação: EQzeJ%2f08XRm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuyYqqA3eLPjSK2pjulx2OPxD6py2N9Dud8acPSbG%2brg%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=EQzeJ%252f08XRm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuyYqqA3eLPjSK2pjulx2OPxD6py2N9Dud8acPSbG%252brg%253d)
 token=EQzeJ%252f08XRm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuyYqqA3eLPjSK2pjulx2OPxD6py2N9Dud8acPSbG%252brg%253d

Descrição: Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D - Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante

Identificação: 42977

Lote/Item: 2/2

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	R\$ 144.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: SAEVO		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: FT412+4 TRANSDUTORES+IMPRESSORA LASER COL+NO BREAK		
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 144.132,10
Marca: VINNO		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: VINNO X1		
21.552.695/0001-94	CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 144.900,00
Marca: VINNO		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: X1		



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica: imagem em modo 2d

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 14/06/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/06/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



NOSSA MISSÃO

Promover soluções para a saúde.

NOSSA VISÃO

Ser referência nacional no mercado de saúde até 2022.

NOSSOS VALORES

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
O segredo do sucesso é o equilíbrio



ATITUDE
A mudança que espero começa por mim, faço acontecer!



UNIÃO
Dividimos ideias, unimos esforços, compartilhamos resultados



FOCO
Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer



PROPOSTA COMERCIAL

Nº: 00013661


À

PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 04.144.150/0001-20

Aos cuidados de

ROBERTO SILVA



Prezados Senhores,

A **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob N° 05.743.288/0001-08, sediada na Rua 104, N° 74, Setor Sul, Goiânia - GO, CEP 74083-300, tem a satisfação de transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento.

1. Objeto da proposta


Constitui objeto da presente proposta o fornecimento do(s) equipamento(s) médico-hospitalar(es), descrito(s) em detalhes no item 2.1 ("Produtos(s)"), que será(ão) fornecido(s) pela Hospcom. Os serviços de instalação e assistência técnica em garantia se estiverem inclusos serão prestados pela Hospcom ou por outra empresa por ela designada, conforme condições explicitadas na presente proposta e em seus anexos. A definição do estabelecimento vendedor, matriz ou filial da Hospcom, será indicada na Nota Fiscal de Faturamento.

2. Condições gerais de venda

2.1. O objeto da presente proposta é(são) a(s) venda(s) do(s) Equipamento(s)

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
	COD: 00035937 DC-40 Crystal PRODUTO SEM DESCRIÇÃO.	P-C-SS-4P Discount	MINDRAY	BRL 33.464,00	1,00	BRL 33.464,00
	COD: 00028476 TRANSDUTOR SETORIAL CARDIACO	P4-2	MINDRAY	BRL 21.217,50	1,00	BRL 21.217,50
	COD: 00031804 TRANSDUTOR LINEAR	L13-3	MINDRAY	BRL 21.217,50	1,00	BRL 21.217,50
	COD: 00030957 TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO CONVEXO	V11-3	MINDRAY	BRL 23.701,50	1,00	BRL 23.701,50
	COD: 00035927 TRANSDUTOR CONVEXO	SC5-1N	MINDRAY	BRL 33.844,50	1,00	BRL 33.844,50
SUBTOTAL: BRL 133.445,00						

Imagens ilustrativas.



Valor total: BRL 133.445,00.

Frete: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF).

Prazo de entrega: 90 DIAS.

Prazo de Garantia: 12 meses para equipamentos, 3 meses para acessórios.

2.2. Forma de pagamento

Condições de pagamento: Pagamento via Transferência Bancária em À Vista - Antecipado.

3. Validade da proposta

A validade desta proposta abaixo, devendo ser assinada e devolvida à Hospcom dentro deste mesmo prazo. Após o termino do prazo a Hospcom não garantira a manutenção dos preços estabelecidos bem como a disponibilidade do material e do serviço na forma descrita nesse documento.

Data de emissão: 13/07/2022.

Data de validade: 13/08/2022.

4. Dados bancários

Banco do Brasil - Agência 1242-4 - Conta Corrente 69869-5.

Documento criado por

Paulo Pacheco (Vendedor)

Email: paulo.pacheco@hospcom.net

Telefone: (62) 3241-5555

