

MEMO Nº 1380/2019 – REFERÊNCIA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS/NUPS


PARA: DEAD/CONTRATOS

Belém, 25 de Novembro de 2019.

Considerando o fato desta Referência Técnica de Medicamentos, ter originado a solicitação de contrato e empenho Nº 7232/2019 da empresa EASYFY SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA, cujo objetivo foi a aquisição de tiras reagentes para verificação de glicemia capilar, contudo a empresa ganhadora do certame, não procedeu com a entrega que estava agendada para o dia 16/11/2019 por ter sofrido um acidente natural que ocasionou a destruição de sua fábrica, conforme descrito no e-mail em anexo;

Considerando ainda, a necessidade de dar continuidade no atendimento dos pacientes assistidos nesta secretaria, através do programa HIPERDIA, viemos através deste solicitar o chamamento dos demais colocados no PE SRP 025/2019, a fim de evitar maiores transtornos no abastecimento da rede SESMA.

Considerando a urgência que o caso requer, estamos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários

 *Maria Pantoja Moreira*
Farmacêutica Clínica
CRF/PA: 5254

Maria Pantoja Moreira

CRF/PA: 5254

Coordenadora Referência Técnica de Medicamentos

ENTREGA PARCIAL DO RETANTE DO EMPENHO 7232/2019

3 mensagens

DRM.CENTRAL SESMA <drm.3.sesma@gmail.com>

17 de outubro de 2019 12:20

Para: Easyfy Saúde <atendimento@easyfy.com.br>

Cco: naizaredigpmb@gmail.com

MEMO Nº3210/2019

Belém, 16 de outubro de 2019.

À EMPRESA EASYFY SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA.

Nesta,

Informamos a Vossa Senhoria o recebimento do Empenho Nº **007232/2019** referente à Aquisição de Materiais Técnicos – **Pregão Eletrônico nº. 025/2019** – **Contrato Nº 0239/2019**, com entrega a ser realizada nesta Divisão de Recursos Materiais – DRM.

Vale ressaltar que caso haja inobservância do prazo acima mencionado, a empresa estará descumprindo cláusula contratual, estando sujeito às penalidades estabelecidas no Art. 3º, parágrafo 2º, inciso VIII, do Decreto do Poder Executivo Municipal de Belém/PA nº 48.804, 01.06.2005 e art. 79, inciso I, c/c art. 78, inciso I, da Lei 8.666/93.

Para que possamos armazenar de forma adequada os materiais, pedimos que a entrega seja feita, em 4 etapas, conforme cronograma estabelecido por esta DRM.

Segue abaixo planilha de entrega:

MATERIAL SOLICITADO	1ª ENTREGA	2ª ENTREGA	3ª ENTREGA	4ª ENTREGA
PRazo P/ ENTREGA	IMEDIATA	16/11/2019	16/12/2019	16/01/2020
TIRA REAGENTE	200.000 UNID	200.000	200.000	200.000

Atenciosamente,

Rosa Sousa

DRM/MT/SESMA


--

Divisão de Recursos Materiais -DRM/SESMA/PMB

Travessa Timbó, 2303 (Entre Av. Rômulo Maiorana e Av. Duque de Caxias)

CEP 66.087-128 – Marco- Belém-PA, Brasil.

Fone/Fax. 3246-3889/3246-3062 DRM



 **TIRA REAGENTE ESAFYSY.pdf**
1780K

DRM.CENTRAL SESMA <drm.3.sesma@gmail.com>

7 de novembro de 2019 16:45

Para: Easyfy Saúde <atendimento@easyfy.com.br>

Cco: naizaredigpmb@gmail.com, rt.materiaistecnicos <rt.materiaistecnicos@gmail.com>

Boa tarde Prezados,

Vimos através deste, saber se o agendamento das Tiras Reagentes 200.000 unds ,que esta previsto para 16/11/2019, será efetuado!

Atenciosamente

Rosa Sousa

DRM/MT/SESMA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **TIRA REAGENTE ESAFYSY.pdf**
1780K

Leonardo Lima de Carvalho <leonardo@easyfy.com.br>

14 de novembro de 2019 15:24

Para: "DRM.CENTRAL SESMA" <drm.3.sesma@gmail.com>

Prezado Senhor(a),

A ToCare Indústria e Comércio de Produtos Médicos S/A, CNPJ: 17.513.528/0001-67, situada na cidade de Santa Rita do Sapucaí/Minas Gerais, é responsável pela fabricação da linha para o monitoramento de glicemia da marca GLICOO, cujos itens também comercializa no solo brasileiro. Trata-se da **primeira e única indústria nacional na linha de monitoramento de glicemia**.

No último dia 24/10, nossa fábrica foi severamente danificada devido à tempestade de granizo que destruiu empresas, carros, plantações e levou o Município a decretar estado de emergência. Os severos danos na fábrica, que podem ser observados nas fotos em anexo, comprometeram totalmente a capacidade de produção, além da perda de todo o estoque da fábrica.

Diante desse trágico evento, a indústria iniciou imediatamente as ações que visam restabelecer suas atividades em uma nova planta fabril também em Santa Rita do Sapucaí, local este que já estava sendo preparado para a expansão da fábrica em 2020. Todo o nosso esforço está sendo direcionado para que retomemos a produção em 03 meses, visando mitigar o impacto para nossos milhares de clientes que contam com nossos produtos para o monitoramento da glicemia e o controle do diabetes, especialmente aqueles pacientes inscritos nos programas de diabetes de seus respectivos municípios.


Nesse difícil momento, estamos elaborando um dossiê técnico do evento, suas consequências e danos, que será enviado para o Município, sempre no sentido de tratar esse momento com a transparência e seriedade que são características da nossa indústria. Contudo, por motivo desse motivo de força maior, indústria está impossibilitada de fornecer qualquer quantidade de produtos nesse momento, até o restabelecimento de suas operações.

Desde já agradecemos a vossa atenção.


Atenciosamente,

Leonardo L Carvalho


6 anexos

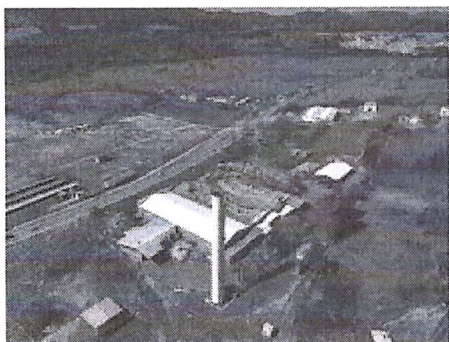

a96dd290-d13a-4419-87f8-f5c0176b33bf.jpg
108K

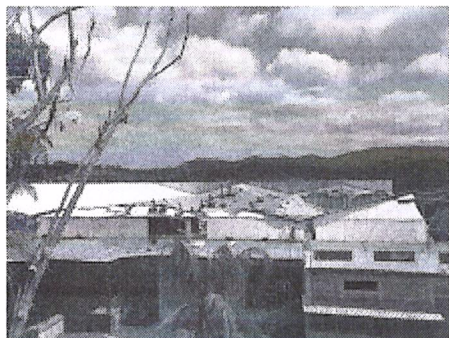

de9732bb-d36c-4773-9ceb-f13a36e42d9b.jpg
190K

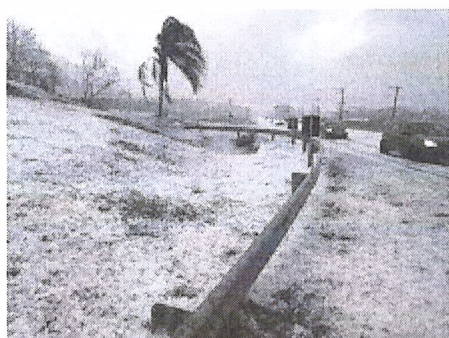

794230d1-a24f-47e4-94fd-109aa4bb2082(1).jpg
91K



84008abd-a2eb-4fd7-b0eb-c4fa06093cb3(1).jpg
144K



465d3c57-efbb-4423-a062-bc5c10461caf.jpg
121K



4bdce430-242f-4396-b48d-ed26f4d5c0dc.jpg
121K